

<b>Verfahrensanweisung</b>	<b>Deutsches Rotes Kreuz</b>  Kreisverband Odenwaldkreis
Überprüfung von sterilen Einmalprodukten	Rettungsdienst

## 1. Ziel und Zweck

In dieser Verfahrensanweisung wird dargestellt, wann die Überprüfung von sterilen Einmalprodukten durchzuführen ist.


Diese Maßnahme ist durchzuführen um die gesetzlichen Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung einzuhalten.

## 2. Geltungs- und Verantwortungsbereich

Diese Verfahrensanweisung gilt für alle Rettungsdienst-Mitarbeiter des Kreisverbandes Odenwaldkreis.

Die Durchführungsverantwortung obliegt der jeweiligen Fahrzeugbesatzung.

## 3. Beschreibung

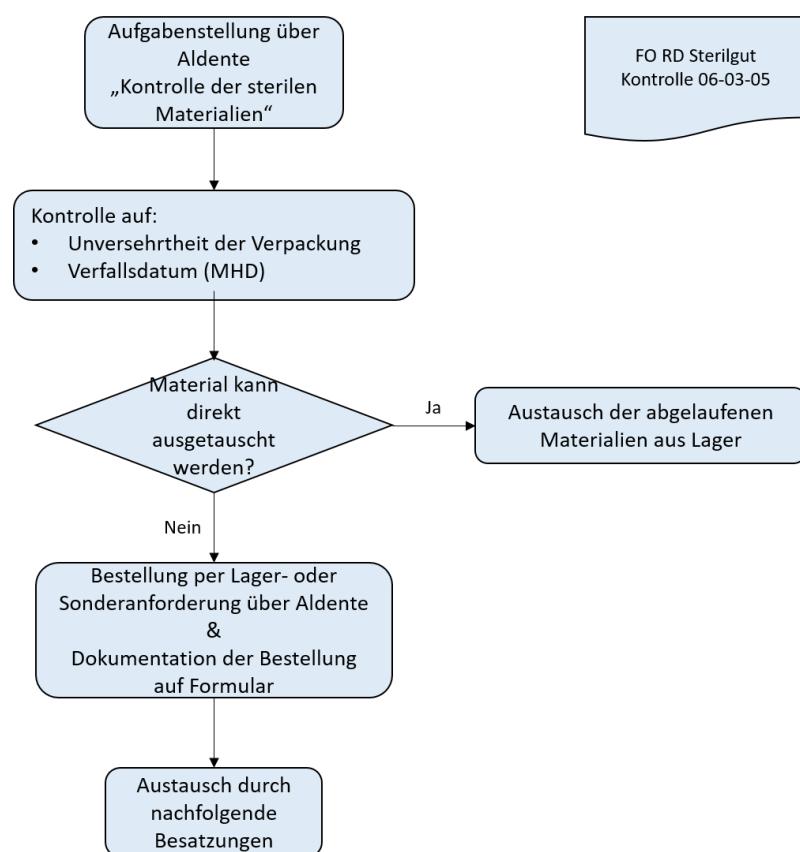

## 4. Mitgeltende Unterlagen

- Medizinproduktegesetz
- Medizinprodukte-Betreiberverordnung

## 5. Qualitätsaufzeichnung

- Aufgabentool Aldente
- FO RD Protokoll Sterilgut-Kontrolle 06-03-05

VA RD Überprüfung von sterilen Einmalprodukten 06-03-04-V07				
Stand:	Ersteller:	Geprüft:	Freigabe:	Seite:
19.05.25	Zellmann, QB RD/HD	Weyrich, RDL	Trautmann, RDL	1 von 1